



VIRAL MARKERLAR/2020-10
Nihai Rapor

Rapor Numarası	VM-202010.27600
Laboratuvar Kodu ve Adı	İSTANBUL LABORATUVARI
Rapor Dönemi	VIRAL MARKERLAR/2020-10
Dönem Başlangıcı/Bitişi	06.10.2020/16.10.2020
Örnek Numarası	VM-20-10-01 / VM-20-10-02
Rapor Tarihi	03.11.2020
Sonuç Giriş Tarihi	13.10.2020

Labpt Kalite Kontrol Programı yeterlilik testi numunelerinin hazırlanmasında taşeron kullanılır.

Labpt Kalite Kontrol Programı, katılımcı bilgilerinin gizliliği ilkesini özümser ve uygular. Katılımcı kendi talebi ile gizlilik hakkından feragat etmediği sürece katılımcı tanımlayıcı bilgileri sadece program organizasyonunda görevli sınırlı sayıda personelce bilinir.

Daha detaylı bilgi için www.labpt.com.tr web sitesinde genel uygulamalar sekmesinin altında yer alan plan protokolü dokümanının inceleyiniz.

LABPT Kalite Kontrol Programı

Tunalı Hilmi Cad. No: 104/3 06680 Kavaklıdere / ANKARA

Tel : (0530) 617 02 88

www.labpt.com.tr

info@labpt.com.tr

Sayın Labpt Kalite Kontrol Program Katılımcısı

İstatistiksel Tasarım:

Labpt Kalite Kontrol Programının, kalitatif sonuç girişi yapılan programlarında, bireysel performans değerlendirmesi katılımcıların üzerinde konsensüs sağladığı cevaba karşı yapılmaktadır. Karşılaştırma için kullanılacak konsensüs değerinde elde edilebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir;

- Katılımcı sayısı en az **10** olmalıdır.
- Katılımcıların **%80** ve üzeri aynı cevap üzerinde konsensüs sağlamış olmalıdır.

Konsensüs değeri oluşturacak şartların sağlanamadığı durumlarda, performans değerlendirmesi yapılmaz. Böyle bir durumda, ilgili teste ait performans değerlendirme alanında "Sonuçların hiçbiri üzerinde konsensüs sağlanamamıştır!" ifadesi ile neden bireysel performans değerlendirmesi yapılamadığı belirtilir. Sadece katılımcı laboratuvarın cevabı, katılımcıların cevap yüzdeleri ve yüzdelerden elde edilen grafik gösterim bilgisi olarak paylaşılır.

Labpt Kalite Kontrol Programını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz...



Uzm. Dr. Cevdet ZÜNGÜN

Labpt Kalite Kontrol Programı

Program Koordinatörü

HBsAg



Sonuçunuz		VM-20-10-01				VM-20-10-02			
		Pozitif				Pozitif			
Konsensüs cevap ile uyumlu sonuç!*									
Değerlendirilen Program	Değerlendirilen Laboratuvar	Negatif Yanıt Veren Lab. Sayısı	Negatif Yanıt Oranı (%)	Pozitif Yanıt Veren Lab. Sayısı	Pozitif Yanıt Oranı (%)	Normal Yanıt Veren Lab. Sayısı	Normal Yanıt Oranı (%)	Sınırdaki Yanıt Veren Lab. Sayısı	Sınırdaki Yanıt Oranı (%)
VM-20-10-01	211	0	0	211	100	0	0	0	0
VM-20-10-02	211	0	0	211	100	0	0	0	0

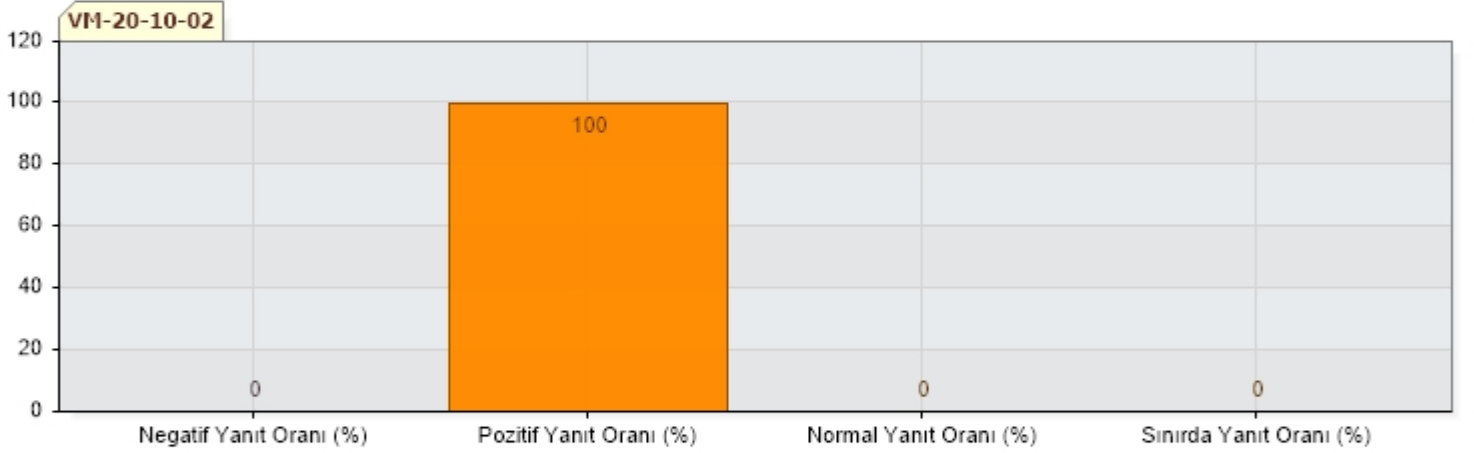

* Kalite testleri için Konsensüs cevap katılımcı sonuçlarının 80%den fazlasının aynı olması ile belirlenir. Konsensüs cevabı oluşması için yeterli uyumun olmaması halinde performans değerlendirilmesi yapılmaz.

Anti-HBs

		VM-20-10-01				VM-20-10-02			
Sonuçunuz		Negatif				Negatif			
		Konsensüs cevap ile uyumlu sonuç!*							
Değerlendirilen Program	Değerlendirilen Laboratuvar	Negatif Yanıt Veren Lab. Sayısı	Negatif Yanıt Oranı (%)	Pozitif Yanıt Veren Lab. Sayısı	Pozitif Yanıt Oranı (%)	Normal Yanıt Veren Lab. Sayısı	Normal Yanıt Oranı (%)	Sınırdaki Yanıt Veren Lab. Sayısı	Sınırdaki Yanıt Oranı (%)
VM-20-10-01	195	183	93.8462	12	6.1538	0	0	0	0
VM-20-10-02	196	193	98.4694	3	1.5306	0	0	0	0

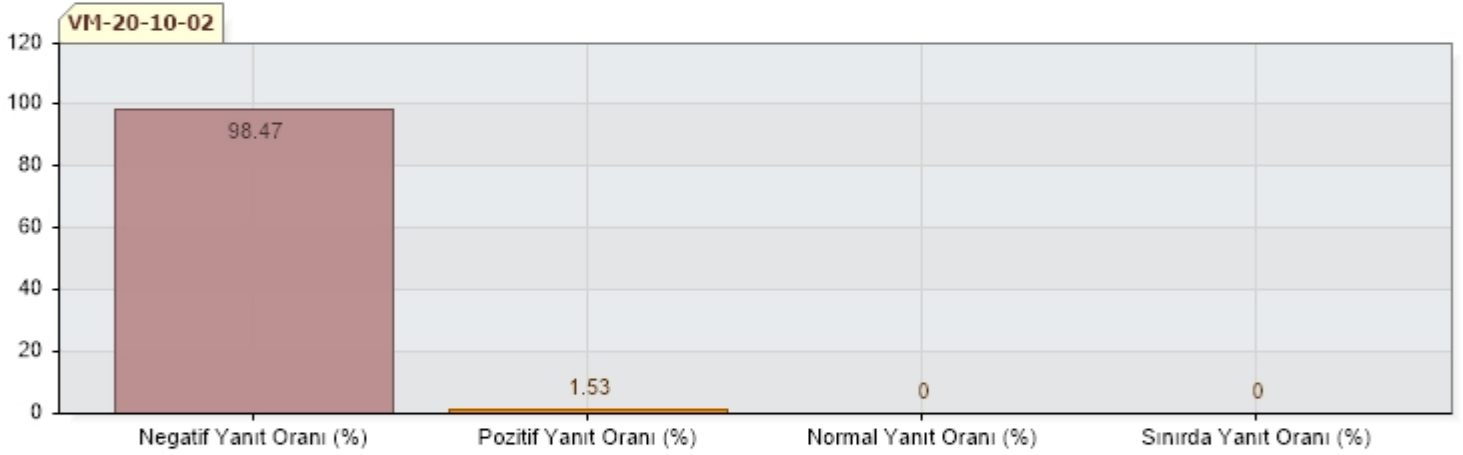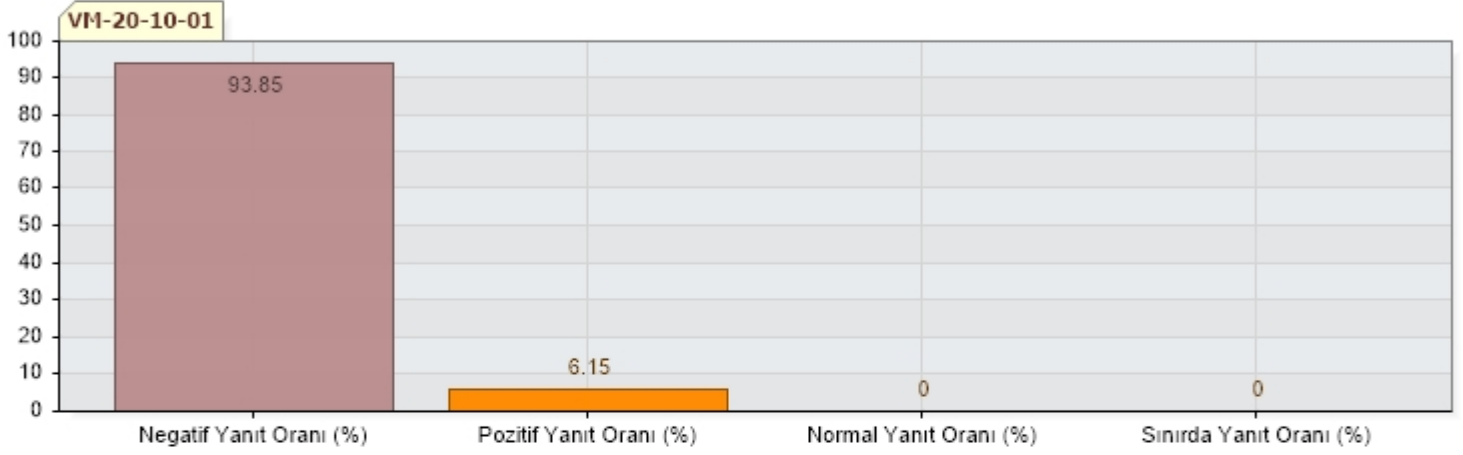

* Kalitatif testler için Konsensüs cevap katılımcı sonuçlarının 80%den fazlasının aynı olması ile belirlenir. Konsensüs cevabı oluşması için yeterli uyumun olmaması halinde performans değerlendirilmesi yapılmaz.

Anti-HCV

VM-20-10-01

VM-20-10-02

Sonuçtur



Negatif

Pozitif

Konsensüs cevap ile uyumlu sonuç!

Konsensüs cevap ile uyumlu sonuç!



Değerlendirilen Program	Değerlendirilen Laboratuvar	Negatif Yanıt Veren Lab. Sayısı	Negatif Yanıt Oranı (%)	Pozitif Yanıt Veren Lab. Sayısı	Pozitif Yanıt Oranı (%)	Normal Yanıt Veren Lab. Sayısı	Normal Yanıt Oranı (%)	Sınırdaki Yanıt Veren Lab. Sayısı	Sınırdaki Yanıt Oranı (%)
VM-20-10-01	210	207	98.5714	3	1.4286	0	0	0	0
VM-20-10-02	210	6	2.8571	204	97.1429	0	0	0	0

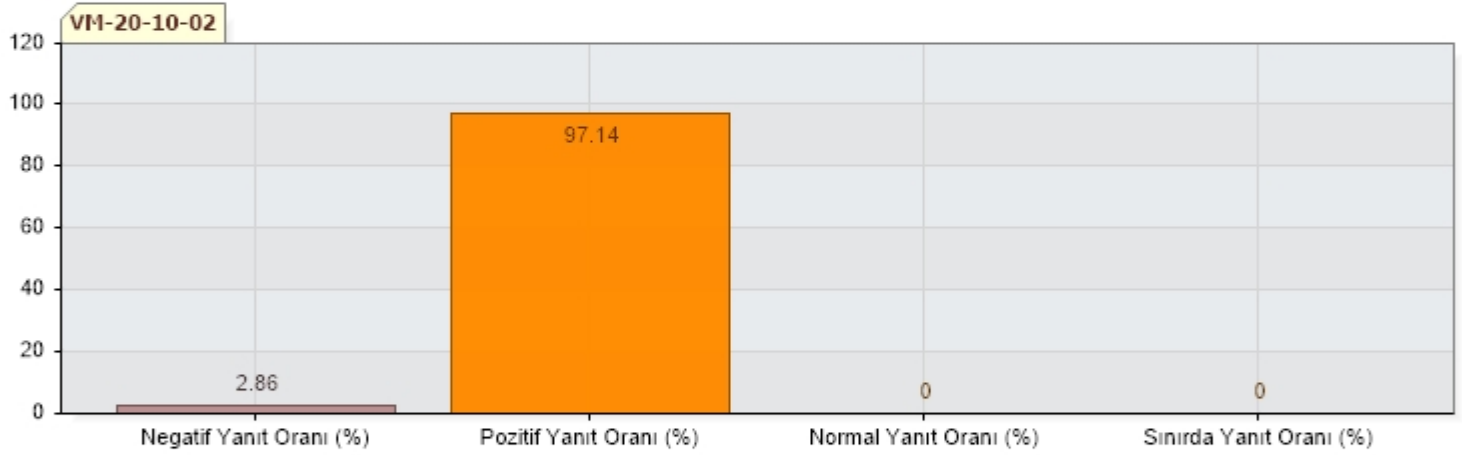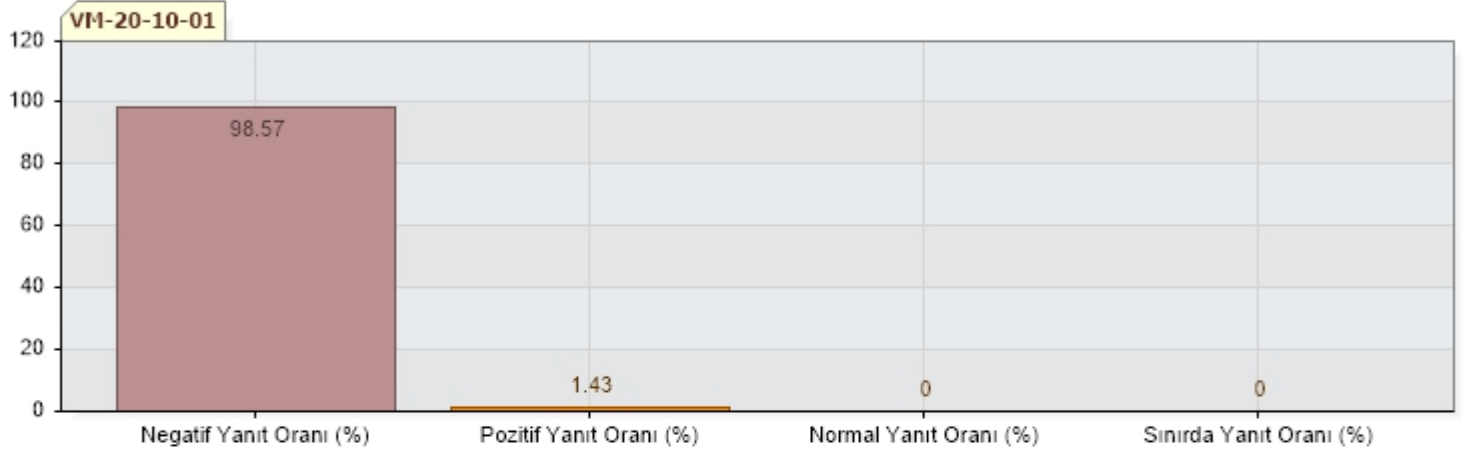

* Kalitatif testler için Konsensüs cevap katılımcı sonuçlarının 80%den fazlasının aynı olması ile belirlenir. Konsensüs cevabı oluşması için yeterli uyumun olmaması halinde performans değerlendirilmesi yapılmaz.

Anti-HIV



		VM-20-10-01				VM-20-10-02			
Sonuçunuz		Negatif				Pozitif			
		Konsensüs cevap ile uyumlu sonuç!*							
Değerlendirilen Program	Değerlendirilen Laboratuvar	Negatif Yanıt Veren Lab. Sayısı	Negatif Yanıt Oranı (%)	Pozitif Yanıt Veren Lab. Sayısı	Pozitif Yanıt Oranı (%)	Normal Yanıt Veren Lab. Sayısı	Normal Yanıt Oranı (%)	Sınırdaki Yanıt Veren Lab. Sayısı	Sınırdaki Yanıt Oranı (%)
VM-20-10-01	209	206	98.5646	3	1.4354	0	0	0	0
VM-20-10-02	209	5	2.3923	204	97.6077	0	0	0	0

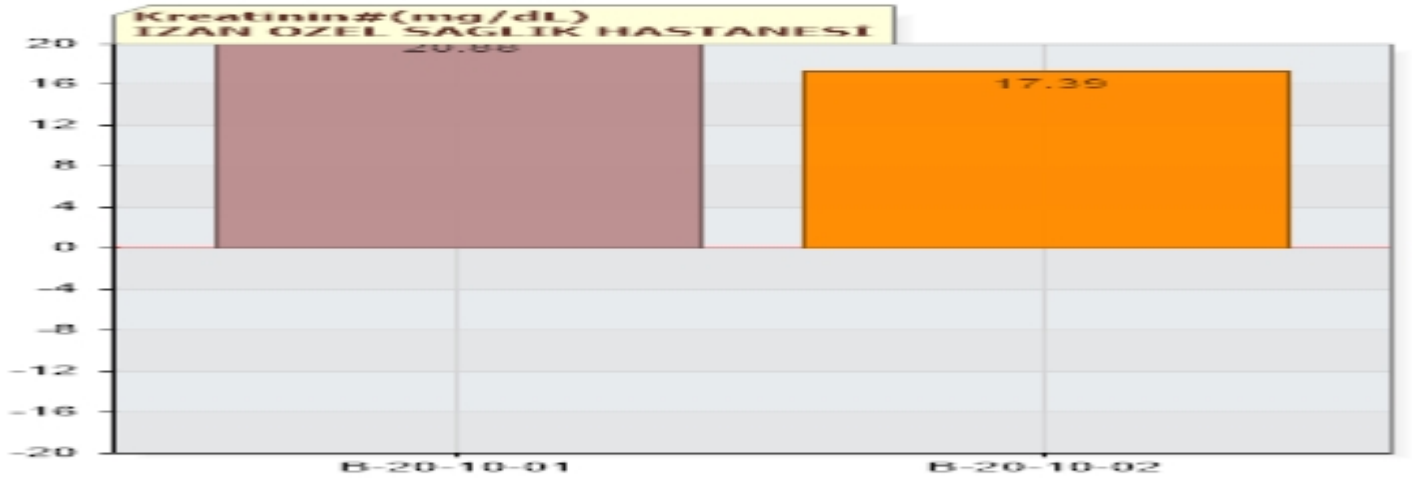

* Kalitatif testler için Konsensüs cevap katılımcı sonuçlarının 80%den fazlasının aynı olması ile belirlenir. Konsensüs cevabı oluşması için yeterli uyumun olmaması halinde performans değerlendirilmesi yapılmaz.

VDRL

		VM-20-10-01				VM-20-10-02			
Sonuçunuz		Negatif				Negatif			
Konsensüs cevap ile uyumlu sonuç!*									
Değerlendirilen Program	Değerlendirilen Laboratuvar	Negatif Yanıt Veren Lab. Sayısı	Negatif Yanıt Oranı (%)	Pozitif Yanıt Veren Lab. Sayısı	Pozitif Yanıt Oranı (%)	Normal Yanıt Veren Lab. Sayısı	Normal Yanıt Oranı (%)	Sınırdaki Yanıt Veren Lab. Sayısı	Sınırdaki Yanıt Oranı (%)
VM-20-10-01	157	156	99.3631	1	0.6369	0	0	0	0
VM-20-10-02	157	153	97.4522	4	2.5478	0	0	0	0

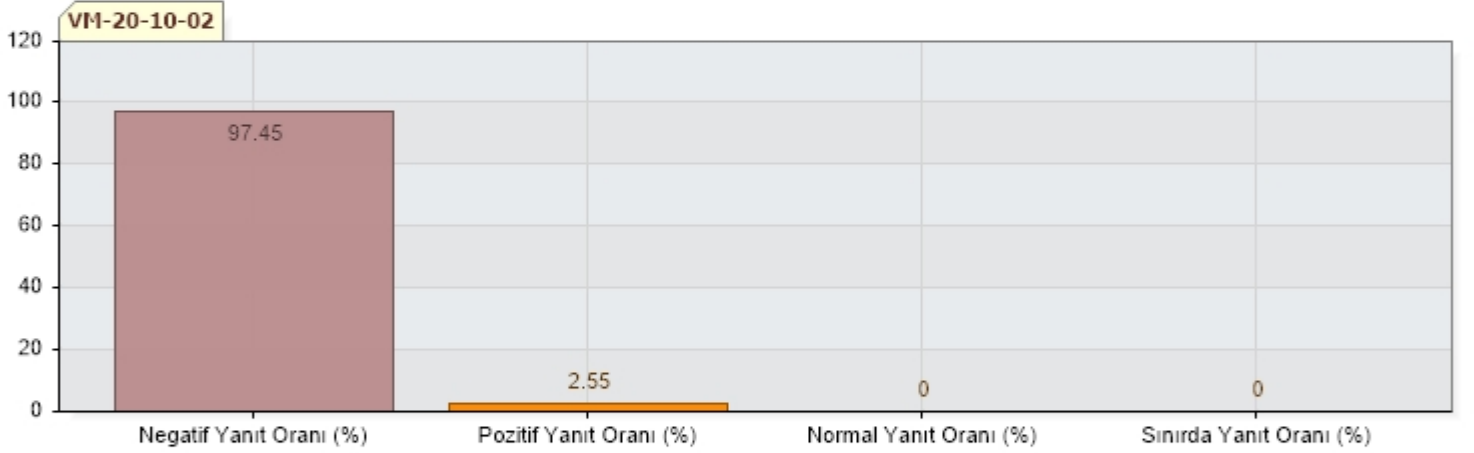

* Kalitatif testler için Konsensüs cevap katılımcı sonuçlarının 80%den fazlasının aynı olması ile belirlenir. Konsensüs cevabı oluşması için yeterli uyumun olmaması halinde performans değerlendirilmesi yapılmaz.